Eppendorf Consumables – it's Your sample



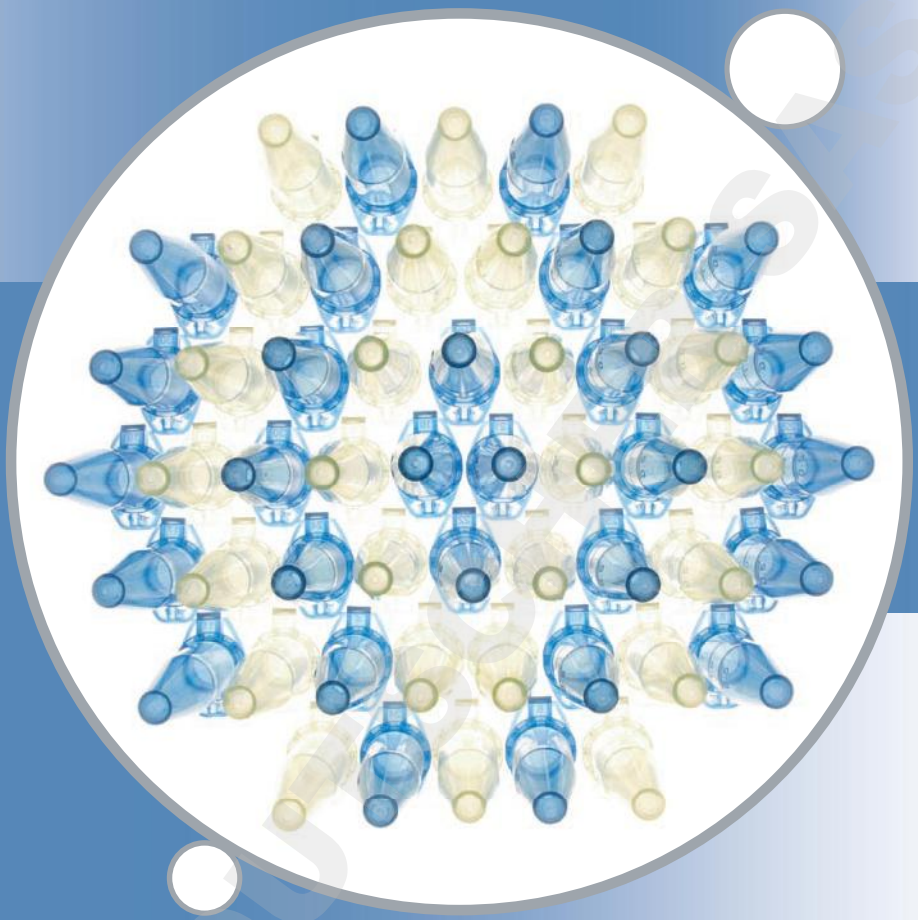

La perfection absolue

Les véritables tubes Safe-Lock Eppendorf

Tubes Safe-Lock : notre tradition de haute qualité ! En 1963, Eppendorf propose le premier microtube aux laboratoires et crée un standard toujours en vigueur aujourd'hui dans tous les laboratoires de recherche et de diagnostic du monde entier. Les Tubes Safe-Lock Eppendorf associent progrès et développement continus depuis plus de 45 ans. Le véritable tube Safe-Lock assure à vos échantillons, une stabilité exceptionnelle pendant la centrifugation, une fermeture parfaite et une protection contre l'évaporation. Faites confiance au véritable tube Safe-Lock Eppendorf parce que vos échantillons méritent le meilleur.

Atouts / caractéristiques du produit

- Le système Safe-Lock empêche l'ouverture accidentelle du couvercle pendant l'incubation
- Fermeture optimale pour obtenir les taux d'évaporation les plus bas
- Grand couvercle dépoli pour faciliter le marquagel Exceptionnelle stabilité en centrifugation pour éviter les tubes cassés
- Couvercle à charnière pour une ouverture facile et sans contamination
- Graduation pour faciliter le repérage des volumes
- Certifié Eppendorf Biopur® ou qualité PCR clean par lot

Pour plus d'informations sur les tubes Safe-lock :
www.eppendorf.fr/consumables

eppendorf

DOMINIQUE DU SOUTIEN

Le tube parfait pour vos échantillons

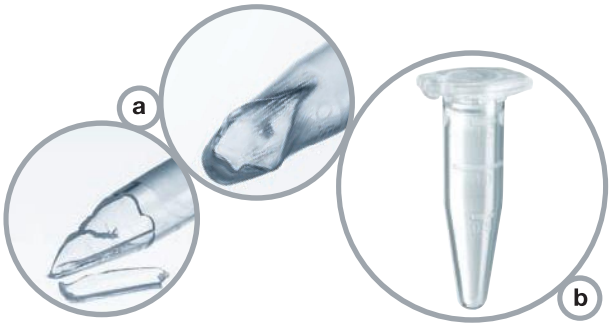

Les essais à 30 000 × g montrent que d'autres microtubes (a) risquent d'éclater pendant la centrifugation, occasionnant une perte d'échantillon – Les tubes Safe-Lock Eppendorf (b) permettent une centrifugation rapide et sécurisée de vos échantillons*[1]!

Fermeture optimale

En particulier pendant l'incubation d'échantillons coûteux ou toxiques, de substances radioactives ou d'ADN, la fiabilité de la fermeture du couvercle est extrêmement importante pour éviter toute perte d'échantillon et toute contamination. Pendant l'incubation au bain-marie, les tubes Safe-Lock Eppendorf restent parfaitement fermés. C'est garanti.

● **Figure – Fermeture du couvercle :** Indique le pourcentage de tubes ouverts pendant une incubation de 100 secondes au bain-marie à 100 °C. Tous les tubes Eppendorf sont restés parfaitement fermés.

Fermeture du couvercle : Nombre de couvercles ouverts

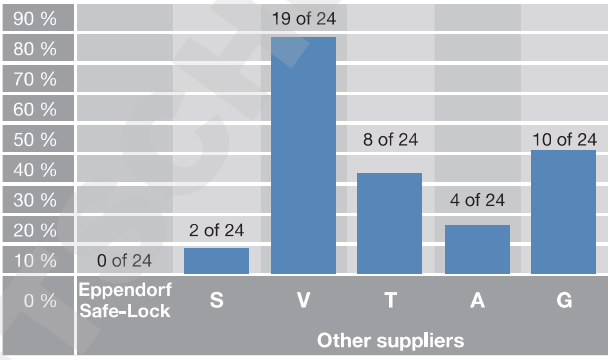

Protection maximum contre l'évaporation

La grande expérience d'Eppendorf en moulage de précision assure l'adaptation parfaite du couvercle Safe-Lock au tube. Cela se traduit par une perte minimale de vos échantillons par évaporation. Vos échantillons sont parfaitement protégés dans toutes les situations.

● **Figure – Evaporation:** Les tubes Eppendorf assurent la meilleure protection contre l'évaporation des échantillons pendant 1 heure d'incubation à 70 °C.

*[2] Les tubes concurrents se sont ouverts pendant l'incubation

Evaporation en ‰

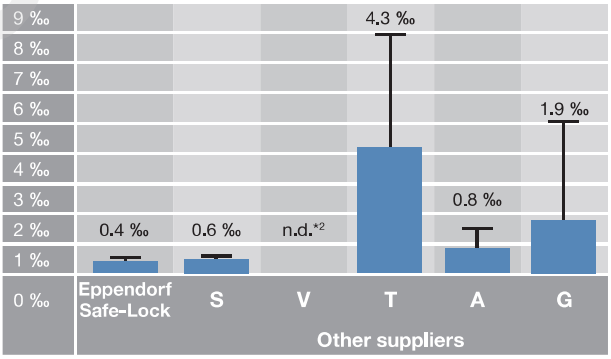

Nomenclature de commande

	Code	Code	Code
Volume	**0,5 ml**	**1,5 ml**	**2,0 ml**
Tubes Safe-Lock, Qualité Eppendorf	**par 500 pièces**	**par 1 000 pièces**	**par 1 000 pièces**
Incolores*[3]	0030 121.023	0030 120.086	0030 120.094
Tubes Safe-Lock, PCR clean	**par 500 pièces**	**par 1 000 pièces**	**par 1 000 pièces**
Exempte d'ADN, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR	0030 123.301	0030 123.328	0030 123.344
Tubes Safe-Lock, Eppendorf Biopur	**par 500 pièces**	**par 100 pièces**	**par 100 pièces**
Conditionnement individuel, stérile, exempt d'agent pyrogène, de RNase, d'ADN et d'ATP	0030 121.570	0030 121.589	0030 121.597

*[1] Tubes Safe-Lock, Qualités Eppendorf et PCR clean: jusqu'à 30 000 × *g* / tubes de 0,5 ml et de 1,5 ml, jusqu'à 25 000 × *g* / tubes de 2 ml. Safe-Lock Tubes, Eppendorf Biopur: jusqu'à 22 000 × *g* / toutes contenances.
*[3] Sont également disponibles les tubes Safe-Lock ambrés (inactinique), bleu, vert, rouge et jaune. Pour plus de précisions et pour la nomenclature de commande, consultez **www.eppendorf.fr/consumables**

eppendorf
In touch with life

Eppendorf France S.A.R.L. · 60, route de Sartrouville · 78230 Le Pecq · France · Tel: +33 1 30 15 67 40 · Fax: +33 1 30 15 67 45 · E-mail: eppendorf@eppendorf.fr · www.eppendorf.fr
New Brunswick Scientific NV-SA · Stationsstraat 180/4 · B-3110 Rotselaar · Belgie/Belgique · Tel: +32 (0) 16 562 831 · Fax: +32 (0) 16 572 753 · Email: sales@nbsnv-sa.be
Vaudaux-Eppendorf AG · Im Kirschgarten 30 · 4124 Schönenbuch · Schweiz · Tel: +41 61 482 1414 · Fax: +41 61 482 1419 · E-mail: vaudaux@vaudaux.ch · www.eppendorf.ch
Application Support: Tel: +49 1803 666 789 · E-mail: support@eppendorf.com

eppendorf® est une marque déposée de Eppendorf AG. Tous droits réservés, y compris graphiques et illustrations. Copyright © 2009 Eppendorf AG
Order No. AQ10 711 030/FR1/3T/1009/FEEL/STEF · Imprimé en Allemagne

DOMINIQUE DUTSCHER SAS