MiniCollect®

greiner BIO-ONE

CE 0197

ES

Lanceta de seguridad PIXIE para incisión en el talón MiniCollect®

Instrucciones de uso

Uso previsto

La lanceta de seguridad PIXIE para incisión en el talón **MiniCollect**® se utiliza para la obtención de muestras de sangre en el talón de los bebés durante análisis de sangre.

Descripción del producto

Las lancetas de seguridad PIXIE para incisión en el talón **MiniCollect**® son dispositivos estériles de un solo uso para incisión en el talón. El dispositivo consta de una hoja de acero inoxidable en una carcasa de plástico y se retrae de forma automática y permanente tras la incisión. El dispositivo penetra en la piel con una oscilación pendular para cortar capilares.

Precauciones/advertencias

- Consulte las políticas y los procedimientos de su centro con respecto a la manipulación de las lancetas de seguridad PIXIE para incisión en el talón **MiniCollect**®.
- Hay enfermedades infecciosas como VHB, VHC y VIH que se pueden transmitir por contacto con muestras biológicas. En caso de exposición a muestras biológicas, asegúrese de que se obtiene la atención médica adecuada.
- Deseche todas las lancetas de seguridad PIXIE para incisión en el talón **MiniCollect**® en recipientes previstos para la eliminación de residuos de riesgo biológico.
- Utilice siempre guantes desechables durante la incisión en el talón y al manipular muestras de sangre capilar, para minimizar el riesgo de exposición.
- No utilice las lancetas de seguridad PIXIE para incisión en el talón **MiniCollect**® después de su fecha de caducidad.
- No utilice las lancetas de seguridad PIXIE para incisión en el talón **MiniCollect**® si se ha activado el mecanismo de bloqueo de la activación antes de sacarla del envase.
- No utilice las lancetas de seguridad PIXIE para incisión en el talón **MiniCollect**® si envase protector tipo blíster ha sufrido algún daño.
- Las lancetas de seguridad PIXIE para incisión en el talón **MiniCollect**® se recomiendan únicamente para incisiones en el talón de bebés.
- El producto es de un solo uso; no lo reutilice.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. El producto no debe entrar en contacto con sustancias tóxicas o corrosivas.

Manipulación

Consulte las recomendaciones del CLSI GP42-Ed7 relativas a la selección del dispositivo adecuado, teniendo en cuenta la edad y el peso del bebé.

Código de color	Profundidad/longitud de la incisión	Aplicación
Verde	0,65 mm de profundidad / 1,40 mm de longitud de la incisión	Prematuros de bajo peso
Naranja	0,85 mm de profundidad / 1,75 mm de longitud de la incisión	Prematuros
Amarillo	1,00 mm de profundidad / 2,50 mm de longitud de la incisión	Recién nacidos

1		Seleccione un punto dentro del área marcada. Precaliente o masajee ese punto. Se puede utilizar una toalla húmeda y caliente (u otros dispositivos de calentamiento) a una temperatura no superior a 42 °C (108 °F) para cubrir la zona durante 3-5 minutos.
2		Limpie el punto de incisión del talón con un hisopo antiséptico (isopropilo al 70 %) y deje que la piel se seque al aire. El alcohol residual puede causar incomodidad al paciente cuando se realiza la incisión y puede afectar a la muestra de sangre, por ejemplo, debido a hemólisis.

4	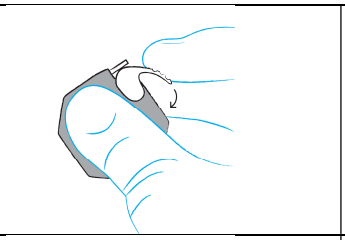	Suelte el mecanismo de bloqueo de la activación presionando la lengüeta de seguridad.
5		Levante el pie por encima del nivel del corazón del bebé. Coloque el instrumento de incisión sobre el talón, asegurándose de que el lado de la hoja del instrumento esté totalmente en contacto con la piel. A continuación, pulse el botón para liberar la cuchilla.
6		Después de la activación, retire inmediatamente el dispositivo del talón del bebé y deséchelo en un contenedor para objetos punzantes de riesgo biológico.
7		Se recomienda limpiar la primera gota de sangre con una gasa estéril, ya que lo más probable es que contenga un exceso de líquido tisular. Ejerza una ligera presión intermitente sobre el tejido circundante. Se **debe** evitar una presión repetitiva fuerte (exprimir), ya que puede provocar hemólisis o contaminación de la muestra por líquido tisular. Según CLSI GP42, 7.ª edición, se recomienda colocar el pie del bebé un poco más bajo que el resto del cuerpo, si es posible.
8		Después de la extracción de sangre, presione suavemente una gasa estéril y seca en el lugar de la incisión hasta que cese la hemorragia.

Información de la etiqueta

	Fabricante	STERILE R	Esterilizado mediante irradiación
	Fecha de caducidad		No reutilizar
LOT	Código del lote		Consulte las instrucciones de uso
REF	Número del catálogo	MD	Producto sanitario
	Precaución	EC REP	Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Fecha de fabricación		

Bibliografía:
CLSI. *Collection of Capillary Blood Specimens*. 7th ed. CLSI standard GP 4. Clinical and Laboratory Standards Institute; 2020.

SteriLance Medical (Suzhou) Inc.
No.168 PuTuoShan Road, New District
215153 Suzhou, Jiangsu (RP China)

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP La Haya
(Países Bajos)

Distribuido por:
Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
(Austria)

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Teléfono +43 7583 6791