

QUICKSHIELD Complete PLUS VACUETTE[®]
(com protetor de rotação)
Instruções de Uso**Indicação de Uso**

O QUICKSHIELD Complete PLUS **VACUETTE**[®] deve ser utilizado apenas com Tubos para Coleta de Sangue **VACUETTE**[®] como um sistema nos procedimentos de punção venosa de rotina. Este dispositivo é projetado com um escudo de segurança, o qual deve ser ativado para cobrir a agulha imediatamente após a punção venosa, pois ajuda na proteção de um possível acidente. As Agulhas VISIO PLUS **VACUETTE**[®] destinam-se à utilização diária de coleta de sangue. A janela de visualização está situada na parte transparente da cânula, o que ajuda o coletador a reconhecer se a penetração na veia foi bem sucedida. Projetadas para utilização única, só deve ser utilizado por profissionais qualificados de acordo com essas instruções.

Descrição de Produto

O QUICKSHIELD Complete PLUS **VACUETTE**[®] é constituído por um adaptador de segurança para tubos **VACUETTE**[®] e uma Agulha para Coleta de Sangue **VACUETTE**[®] VISIO PLUS pré-introduzida em uma embalagem tipo *blister*. Trata-se de um adaptador de plástico estéril com escudo de segurança de uso único.

Precauções/Cuidados

1. Não usar o QUICKSHIELD Complete PLUS **VACUETTE**[®] quando danificado.
2. Qualquer QUICKSHIELD Complete PLUS **VACUETTE**[®] em contato com sangue torna-se contaminado e deve ser descartado imediatamente.
3. Não reencapar a agulha.
4. Não entortar a agulha.
5. Após a punção venosa, descarte o conjunto usado em recipiente apropriado de acordo com as políticas e procedimentos da instituição.
6. Manter as mãos atrás da agulha durante todo o manuseio e descarte.
7. Manipular todas as amostras biológicas e coleta de sangue de acordo com as políticas e procedimentos de biossegurança de sua instituição.
8. Siga o protocolo da instituição no caso de qualquer exposição à amostra biológica (por exemplo, através de uma lesão), uma vez que essas amostras podem transmitir HIV, hepatite viral ou outra doença infecciosa.
9. Descartar todo material perfurocortante em recipiente apropriado.
10. Luvas devem ser usadas em todos os momentos durante a punção venosa para minimizar o risco de exposição.

Armazenamento

Armazenar a 4–36°C (40–97°F).

NOTA: Evite exposição direta à luz solar. O armazenamento em temperatura acima do recomendado pode danificar o produto.

Manuseio**LEIA ESTAS INFORMAÇÕES ANTES DE REALIZAR A PUNÇÃO VENOSA.**


USE LUVAS DURANTE A PUNÇÃO VENOSA E AO MANIPULAR TUBOS DE COLETA DE SANGUE PARA MINIMIZAR O RISCO DE EXPOSIÇÃO A PATÓGENOS!

1. Gire a embalagem e remova a parte posterior da agulha.

NOTA: A etiqueta perfurada é um indicador de esterilidade e integridade do produto. Caso as etiquetas apresentem-se danificadas, descarte a agulha e selecione outra que esteja íntegra. **NOTA:** Não entortar as agulhas e não usar QUICKSHIELD Complete PLUS **VACUETTE**[®] quando a agulha estiver torta.

O ponto sobre a tampa da agulha indica a localização do bisel.

2. O escudo pode rodar para a posição desejada onde se mantém estável durante a punção venosa.
3. Selecionar o local da punção. Aplique o torniquete (máx. 1 minuto). Realize a antisepsia no local. Não apalpar o local da punção venosa após a antisepsia!
4. Posicionar o braço do paciente inclinado para baixo. Remova a capa protetora da agulha. Realizar a punção venosa com o braço do paciente inclinado para baixo.
5. Coloque os tubos sucessivamente no QUICKSHIELD Complete PLUS **VACUETTE**[®]. Os tubos devem estar centralizados no QUICKSHIELD Complete PLUS **VACUETTE**[®] para evitar a penetração da parede lateral e posterior perda prematura do vácuo.



- Remover o torniquete assim que o sangue flui no tubo. Não permitir que o conteúdo do tubo entre em contato com a tampa ou com o final da agulha durante o procedimento, isto é, sob nenhuma circunstância o tubo deve ser virado para baixo durante o procedimento. Sempre segurar o tubo pressionando com o polegar para garantir o preenchimento completo do tubo.
NOTA: Ocasionalmente, o sangue pode vaziar a partir da capa de borracha da agulha. Pratique as precauções universais de biossegurança para minimizar a exposição a patógenos.
- Coloque os tubos sucessivamente no adaptador. Assegure-se que o conteúdo do tubo não entre em contato com a tampa ou a ponta da agulha durante a coleta de sangue.
- Logo que o sangue parar de fluir no último tubo, removê-lo e depois cuidadosamente remover a agulha da veia e aplicar o material para estancamento até parar o sangramento. Quando o sangue parar, aplique um curativo se necessário.


Não reencepe agulha! O reencepe de agulhas aumenta o risco de acidentes com perfurocortantes.

NOTA: Após a punção venosa, o topo da agulha pode conter sangue residual. Tome as precauções adequadas ao manusear os tubos para evitar contato com o sangue.

Ativação do Escudo de Segurança

Imediatamente após a remoção da agulha da veia, utilizar os seguintes procedimentos para ativar o escudo de segurança para evitar ferimentos causados por agulhas.

- Ative o escudo de segurança, pressionando suavemente o escudo para a agulha sobre uma superfície estável. A ativação pelo polegar também é possível, no qual o polegar deve permanecer atrás do escudo todo o tempo. (Veja A1/A2)
- Um clique audível é ouvido assegurando ao usuário que o escudo de segurança foi corretamente e totalmente ativado.
- Assim, o risco de um ferimento por agulha é praticamente eliminado. (B)
Descarte o conjunto QUICKSHIELD Complete PLUS **VACUETTE**® em um dispositivo de descarte apropriado. (C)

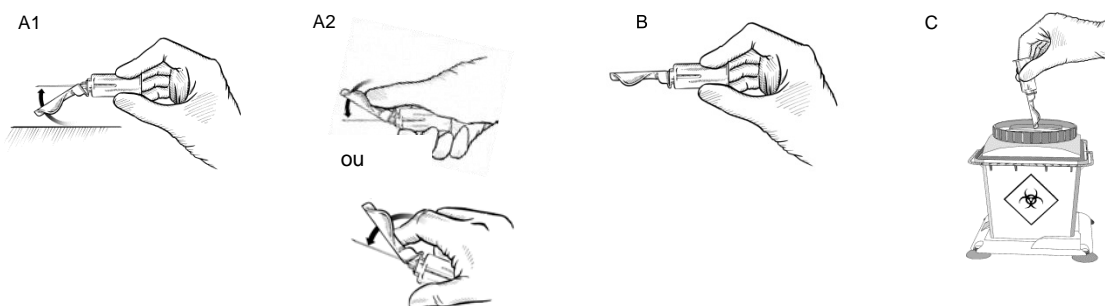

NOTA: Não force para liberar ou reativar o mecanismo de segurança depois de ter sido ativado.

Descarte

As precauções universais de biossegurança e as diretrizes de descarte seguro de material devem ser seguidas de acordo com o protocolo da instituição. Luvas descartáveis previnem o risco de infecção. Adaptadores contaminados devem ser descartados imediatamente após a coleta de sangue em recipientes apropriados.

Informações da Etiqueta

	Fabricante		Esterilização por Radiação
	Prazo de validade		Não Reutilizar
	Número do Lote		Consultar as Instruções de Uso
	Número de Item		



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Straße 32,
4550 Kremsmünster
Austria

Importador e Distribuidor: Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Av. Affonso Pansan, 1967 – Vila Bertini – CEP. 13.473-620 – Americana – SP
Fone +55 19 3468-9600 / FAX +55 19 3468-9601
CNPJ 71.957.310/0001-47 – Site: www.gbo.com

Produto de Uso Médico

Responsável Técnico: Dra. Nádia Camila Gennaro Alves – CRF-SP nº 32.272

CADASTRO NA ANVISA / MS 10290310046

Informações de uso do produto, solicitar via e-mail: suporte@gbo.com