

**VACUETTE**[®] **QUICKSHIELD** Säkerhetsrörhållare
(med vridbart skydd)
Användningsinstruktioner**Avsedd användning**

VACUETTE[®] QUICKSHIELD Säkerhetsrörhållare är avsedd att användas endast med **VACUETTE**[®] provtagningskanyler för flera användningar, **VACUETTE**[®] VISIO PLUS-kanyler och **VACUETTE**[®] provtagningsrör för blod som ett system i rutinmässig blodprovstagning. Denna enhet är utformad med ett säkerhetsskydd som kan aktiveras för att täcka kanylen omedelbart efter provtagningen vilket skyddar mot oavsiktliga nålsticksskador. Denna enhet får bara användas av korrekt utbildad sjukvårdspersonal och enligt dessa anvisningar.

Produktbeskrivning

VACUETTE[®] QUICKSHIELD Säkerhetsrörhållare är en osteril rörhållare av plast för engångsbruk utformad med ett säkerhetsskydd som kan aktiveras för att täcka kanylen omedelbart efter provtagningen.

Försiktighetsåtgärder/Varningar

1. Använd inte **VACUETTE**[®] QUICKSHIELD Säkerhetsrörhållare om den är skadad.
2. En **VACUETTE**[®] QUICKSHIELD Säkerhetsrörhållare som kontamineras med blod anses som smittfarlig och måste omedelbart tas om hand.
3. Sätt inte på locket på kanylen igen.
4. Böj inte kanylen.
5. Efter provtagningen ska du kassera kanylen och **VACUETTE**[®] QUICKSHIELD Säkerhetsrörhållare som en enhet i en lämplig behållare för vassa föremål enligt policyn och procedurerna på din institution.
6. Håll alltid händerna bakom kanylen vid användning och omhändertagande.
7. Vid hantering av alla biologiska prov och vassa tillbehör för blodprovstagningen måste gällande policy och procedurer för din institution följas.
8. Sök omedelbart vård om du exponeras för någon form av smittorisk (t.ex. genom sticksskador). HIV, viral hepatit och andra infektiösa sjukdomar kan överföras genom kontakt med biologiska prover.
9. Vid avfallshanteringen ska avfallsbehållare användas som är avsedda för detta ändamål.
10. Handskar ska alltid bäras vid blodprovstagning för att minimera exponeringsrisken.

OBS: VACUETTE[®] QUICKSHIELD Säkerhetsrörhållare är utformade för optimal användning med **VACUETTE**[®] provtagningskanyler för flera användningar (förutom 18G) och **VACUETTE**[®] VISIO PLUS-kanyler från Greiner Bio-One. Användaren blir själv ansvarig om kanyler från andra tillverkare används.

Förvaring




Förvara hållare vid 4–25°C

OBS: Undvik exponering mot direkt solljus. Överskridande av maximalt rekommenderad förvaringstemperatur kan leda till försämring av hållaren.


Handhavand**LÄS NOGA IGENOM ALL NEDANSTÅENDE INFORMATION INNAN DU GENOMFÖR BLODPROVSTAGNING.**

Använd handskar under blodprovstagning och vid hantering av provtagningsrör för att minimera exponeringsrisken.

1. Avlägsna skyddet från kanylens ventildel.
OBS: Den perforerade etiketten förenklar inte bara identifieringen utan är också en indikator på sterilitet och produktintegritet. Om perforeringen är bruten eller skadad ska du kassera kanylen och välja en annan.
2. Gånga in kanylen i **VACUETTE**[®] QUICKSHIELD Säkerhetsrörhållare. Kontrollera att kanylen sitter fast ordentligt och inte kan lossna under användningen.
OBS: Felaktigt ingångande av kanylen i **VACUETTE**[®] QUICKSHIELD Säkerhetsrörhållare kan resultera i skador på hållarens gängor och/eller på kanylen. Denna skada kan göra att kanylen lossnar under provtagningen.
OBS: Böj inte kanyler och använd inte **VACUETTE**[®] QUICKSHIELD Säkerhetsrörhållare om kanylen är böjd.
3. Punkten på kanyllocket visar avfasningens plats.
4. Skyddet kan vridas till önskad position på hållaren där det förblir stabilt under provtagningen.
5. Välj insticksplatsen. Stasa venen (max. 1 min) och desinficera insticksplatsen. Ingen palpation efter rengöringen!
6. Håll patientens arm nedåtriktad. Ta bort kanylens lock. Genomför provtagningen med patientens arm nedåtriktad och rörlocket överst.

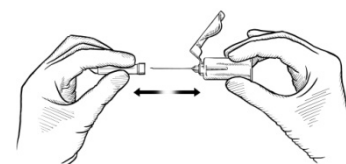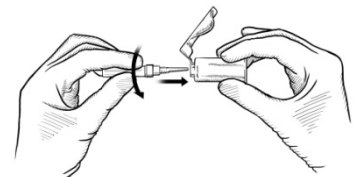

- Tryck in röret i **VACUETTE® QUICKSHIELD** Säkerhetsrörhållare och på kanylventilen så att gummimembranet punkteras. Centrera rören i **VACUETTE® QUICKSHIELD** Säkerhetsrörhållare när locket penetreras för att förhindra penetrering av sidoväggen och efterföljande förtida vakuumförlust.
- Släpp stasen så snart blod kan ses i röret. Låt inte rörets innehåll komma i kontakt med locket eller änden av kanylen under proceduren, dvs. under inga omständigheter ska röret vändas upp och ned under proceduren. Håll röret med tummen bakom rörets botten i rätt position tills röret har fyllts fullständigt.



OBS: Blod kan ibland läcka ut vid gummiskyddet på kanylen. Följ de allmänna säkerhetsriktlinjerna för att minimera risken att komma i kontakt med potentiellt infektiöst material.

- Placera efterföljande rör i hållaren. Kontrollera att rörets innehåll inte kommer i kontakt med locket eller kanylens spets under blodinsamlingen.
- När blodet slutar flöda in i det sista röret tar du försiktigt bort kanylen från venen och trycker en torr, steril tuss hårt mot insticksplatsen tills blödningsen upphör. Vid behov kan ett sterilt plåster/förband användas när koagulering har skett.


Sätt inte på locket på kanylen igen! Återförslutning av kanyler ökar risken för stickskador.

OBS: Efter provtagningen kan restblod finnas kvar i korkens fördjupning. Vidta åtgärder för att förhindra direkt kontakt med blodet under hantering av rören.

Aktivering av säkerhetsskyddet

Omedelbart efter att kanylen har tagits bort från venen används följande procedurer för att aktivera säkerhetsskyddet och förhindra stickskador.

- Aktivera säkerhetsskyddet genom att försiktigt trycka skölden mot nålen på en stabil yta. Det går även att aktivera med en tumme eller ett finger och därför ska tummen och fingret alltid vara bakom skölden. (Se A1/A2)
- Ett klickljud hörs när skyddet har aktiverats korrekt och fullständigt. Risken för stickskador är då i stort sett eliminerad. (B)
- Kassera den använda kanylen med **VACUETTE® QUICKSHIELD** Säkerhetsrörhållare i en lämplig avfallsbehållare. (C)

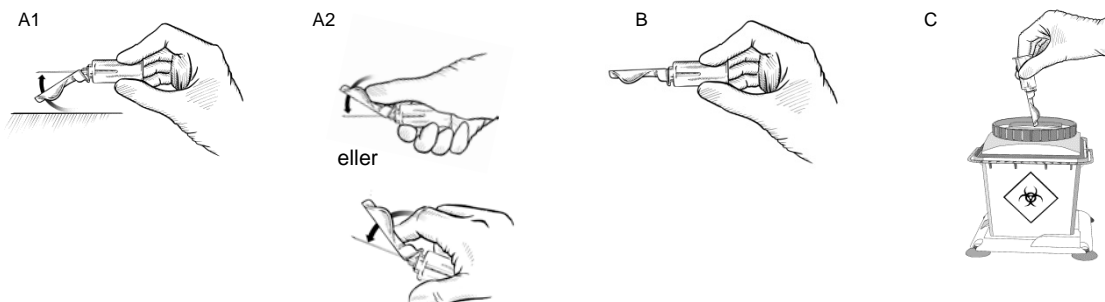










OBS: Använd inte kraft för att frigöra eller återaktivera säkerhetsmekanismen efter att den har aktiverats.

Avfallshantering

lakta och följ allmänna hygienriktlinjer och lagstadgade bestämmelser för korrekt avfallshantering av infektiöst material. Engångshandskar kan minska risken för infektioner. Kontaminerade hållare måste omedelbart efter blodprovtagningen kasseras i lämpliga avfallsbehållare för biologiskt riskmaterial som sedan kan autoklaveras och förbrännas.

Märkning på produktetiketter

	Tillverkare	 	Steriliserad med hjälp av bestrålning
	Utgångsdatum		Återanvänd inte
	Batchnummer		Konsultera användningsinstruktionerna
	Artikelnummer		

 Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Straße 32,
4550 Kremsmünster
Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Phone +43 7583 6791